

政府采购 中标通知书

江苏新启医疗器械有限公司：

贵单位在如东县马塘镇中心卫生院彩色超声诊断系统项目（项目编号：JSZC-320623-HWZX-G2025-0703，采购代理编号：0675-256JOC016113）中中标。总中标金额：RMB 1,910,000.00。望贵单位接通知后 30 天内与如东县马塘镇中心卫生院商签合同。

特此通知。

(代理公司签章)



江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路 56 号大唐科技大厦 A 座高区
15 楼

电话：025-84795467、84795989

日期：2025-11-11

购销合同

甲方：如东县马塘镇中心卫生院

住所地：江苏省如东县

乙方：江苏新启医疗器械有限公司

乙方社会信用代码：91321291MA270WETON

住所地： 泰州市医药高新技术产业开发区药城大道 900 号医疗器

械区二期综合楼 5 层 032 室

经公开招标，根据项目编号为 JSZC-320623-HWZX-G2025-0703 彩色超声诊断系统项目中
标结果，就乙方销售给甲方设备，特订立本合同。

一、设备名称、型号、数量和价格

设备名称	生产厂家	规格型号	单位	数量	单价（元）	成交总价（元）
彩色超声诊断 系统	飞利浦医疗(苏州)有 限公司	EPIQ 7C EXP	套	1	1910000	1910000
总计含税价人民币（大写）：壹佰玖拾壹万圆整					小写：1910000	

二、设备详细配置清单见附件。

三、付款方式：合同签订后支付合同总额的 30%，货到安装，验收合格后凭验收报告、
设备原厂质保函并加盖公章及设备总价全额合法票据后支付总货款的 60%，自验收合格
之日起满三年中标人再次培训并履行好质保责任的前提下支付总货款的 10%。

本合同所涉款项均付至乙方指定的以下收款账户：

户名：江苏新启医疗器械有限公司	开户行：招商银行股份有限公司泰州分行
银行账号：523901334910301	

四、 交货期：合同签订之日起 45 天之内货物运抵甲方。设备安装时出厂时间不超过 6
个月。乙方每逾期一周交货，按设备总价的 5%向甲方支付违约金，该违约金可直接
从甲方给付乙方的设备款中直接扣付。

五、 交货地点：甲方所在地。

六、 质保期：上述设备免费保修 48 个月；保修期内如机器无法及时修复而影响临床使用
时立即更换新机给院方，保修期外乙方对本设备终身负责维修。

七、 资质、质量要求及技术标准：

1. 特别提醒条款：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文

品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号；d、进口货物或部件的原产地证明、报关证明、完税证明、商检证明及编号、质量合格证书、出厂前检测报告等资料；e、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；f、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责，包括但不限于甲方解除本合同即设备作退货处理，乙方返还甲方已给付的设备款，乙方承担违约责任。

甲方已充分告知和说明且乙方已充分知晓以上特别提醒条款内容之实质，并承诺满足。

乙方法定（授权）代表人签字： 何建弟

2. 乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需要提供相关认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。

3. 乙方保证所供设备型号是最新的，且是用符合国家相关行业标准的优质材料和工艺制成、全新，并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方负全部责任。

4 乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，如换货或退货后仍验收不合格，则甲方有权解除本合同，设备作退货处理，乙方返还甲方已给付的设备款，乙方承担违约责任。由此引起的一切损失由乙方承担。

八、设备到货、安装和验收要求：

1. 乙方须提前三天通知甲方，设备到货时间，以便甲方安排好接收工作。乙方负责运输（包括上、下力）；设备到货后，乙方应在二十四小时内开始进行设备的免费安装和调试。设备安装时，乙方必须事先与甲方设备科联系，并与设备科共同参与开箱验收、安装调试，否则引起的一切责任由乙方承担。

2. 如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件地为甲方永久免费打开。

3. 设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作，直至通过验收。

九、售后服务要求：

1. 确保设备保修期内开机率为 95%，如设备故障停机率超过 5%（一年按 365 天计算，每年 18 天），每超过一天，保修期延长两周。

2. 保修期自甲方验收合格之日算起（以甲方的验收报告单日期为准），质保期内设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后 2 小时内予以电话响应，四小时内人员到现场维修，否则甲

方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。在质保期满后，出现设备故障时，乙方仍需做好设备终身售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决，以优于市场的价格只收配件费，免收人工费。

3. 无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师来甲方维修本设备，必须事先与甲方设备科取得联系；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则由此引起的一切责任由乙方负责。

4. 乙方负责免费提供日常运行维护所需的全部技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘等），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

十、技术培训：

在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，解答甲方人员提出的问题。

十一、其他约定事项：

1、甲乙双方共同确认本合同首部所载明的住所地，为甲乙双方有效的送达地址。今后凡与本合同项下有关的文书函件以及相关法律文书的送达地址均以此为准。甲乙双方承诺在住所地发生变更时，应及时书面通知对方，否则因住所地不准确，或住所地变更后未及时书面告知合同相对方，导致合同往来文书函件及法律文书被拒绝签收、无法送达等情形的，应自行承担有效送达的法律后果。

2、本合同经甲乙双方法定代表人签字加盖双方公章或合同专用章后生效。

3、本合同履行过程中，如发生争议双方协商解决，协商不成双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4、甲乙双方均需按照合同约定履行合同义务，如违约违约方需向守约方支付合同价款 30% 所计取的违约金【本合同另有约定的，从其约定】，此外还需承担守约方因此而产生的案件受理费、保全费、保全保险费、律师代理费等费用。

十二、组成本合同的文件包括：

1. 本合同条款；
2. 本项目的采购文件和供方应标文件；
3. 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；
4. 供需双方其它约定事宜。

十三、本合同内容如有冲突，以采购文件为准。

十三、合同生效：本合同由供需双方签字盖章后生效。

十四、本合同一式肆份，均具有同等法律效力，需方执叁份，供方执壹份。

协议签署地点：江苏如东。

甲方：如东县马塘镇中心卫生院

法定【授权】代表人：

分管领导：

2025 年 12 月 03 日

乙方：江苏新启医疗器械有限公司


法定代表人：

业务部门代表：

2025 年 12 月 03 日

附件：

设备配置

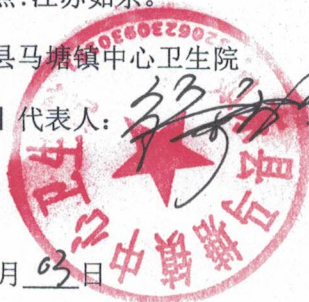

TO : 如东县马塘医院		
SUBJECT: Philips EPIQ7C exp高端智能心超 配置		
DATE :2025年11月7日		
ITEM	P/N	DESCRIPTION
1	EPIQ7C exp	Philips EPIQ7C exp高端智能心超
		21.5寸纯平超薄LCD高分辨率显示器
		12寸滑屏操作触摸屏
		nSIGHT平台
		集束精准发射和海量并行处理
		高达7071744数字化通道
		320dB动态范围
		全像素集成成像
		新一代SonoCT实时复合成像技术
		新一代XRES磁共振自适应像素优化技术
		组织多普勒成像
		ICQ脑卒中预警软件
		TAC组织差异校正技术
		LV0左心室腔造影
		负荷超声心动图
		WideScan扩展成像技术
		iOPTIMIZE智能优化技术
		具有脉冲反相谐波技术的组织谐波成像
		2D, Color/CPA, PW三同步功能
		High-Q实时自动多普勒分析
		二维、M型、解剖M型, PW, CW, 高脉冲, 彩色多普勒
		一体化工作站图像管理系统
		Dicom3.0联网, 支持无线连接
		电影回放;高分辨放大, 伪彩
		测量工具包括:距离, 面积, 周长和容积
		显示器和操作面板720度自由调整
		4个成像探头无针式接口
		环保设计, 减少25%耗电量, 静音设计, 37-41db
2	V/V CONF1	电压和视频配置, 230V/50Hz-PAL
3	U01	SmartExam扫描专家: 规范检查流程, 自动模式切换等
4	U02	AutoScan (实时iScan) 智能扫描技术: 实时自动优化增益和TGC
5	U03	AutoDoppler智能多普勒技术: 实时自动调节取样框位置和偏转方向, 实时自动调节取样容积位置和取样线角度
6	U10	实时、触发心肌灌注造影成像
7	2DB1-1	感兴趣区域时间密度定量分析, 用于: 造影剂, 灰阶, 彩色, 能量, 声学密度分析 (ROI)
8	2DB1-2	血管内的中膜厚度自动测量 (IMT)
9	2DB1-3	心肌应变显像 (速度, 应变, 应变率) (strain)
10	2DB1-4	自动二维心功能定量 (AQ) 及彩色室壁运动分析 (CK), 自动二尖瓣环运动分析 (TMAD) (a2DQ)
11	2DB1-5	自动左室应变定量 (Auto Strain LV)
12	MPI	微视血流成像 (MPI)
13	S5-1	S5-1纯净波相控阵探头
14	C5-1	C5-1纯净波凸阵探头
15	L12-5B	L12-5 50mm超宽频带线阵探头
16	L12-3	L12-3 超宽频带线阵探头
17	J04	操作手册